



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

ISO 9001 : 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004

ISO 27001 : 2005

NZZ/41/P/14

Bydgoszcz, dnia 22.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego, drobnego sprzętu medycznego, sprzętu laparoskopowego i histeroskopowego, narzędzi i akcesoriów endoskopowych, implantów neurochirurgicznych

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy-dotyczy zał. nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy projektu umowy-dotyczy zał. nr 3 do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 16 :

16. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

19. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy-dotyczy zał. nr 3 do SIWZ

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 1 pkt. 5 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy projektu umowy-dotyczy zał. nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu § 6 ust 3 b :

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3a do SIWZ

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 1 ust. 5 :

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 2,5% całkowitej wartości brutto o której mowa w ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3a do SIWZ

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny począwszy od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu. Strony ustalają, iż Zamawiający przeprowadzał będzie kwartalne przeglądy powierzonego sprzętu medycznego, w ramach których możliwe jest zgłoszenie Wykonawcy możliwości wymiany sprzętu medycznego o zbliżającym się upływie terminu przydatności do użycia. Strony ustalają, iż Zamawiający nie może żądać dokonania wymiany sprzętu medycznego o terminie przydatności do użycia krótszym niż 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3b do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania
(zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością
Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem
albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym
żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i
dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek
części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu.
Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem
.....niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania
przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu
przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o
których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące
nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim
przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez
Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru
podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego
wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania
niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3b do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3b do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów :

§ 4 ust. 15, 18

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go kara umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

§ 5 ust. 4

4. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu użyczenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu użyczenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu użyczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3b do SIWZ

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust 1a Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT." Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3b do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu § 7 ust 3 b :

3. Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3c do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 5, 10, 12 :

5. W przypadku nie dostarczenia Towaru w ustalonym terminie albo dostarczenia Towaru nie spełniającego wymagań określonych w ofercie przetargowej lub w § 1 ust. 4 niniejszej umowy i nie dostarczenia Towaru spełniającego wymogi w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający będzie miał prawo, według swojego wyboru:

a. po pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

b. bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. , jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części dostawy

10. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia w tym terminie Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości

3 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy,

lub

b. do żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień następujący po terminie wyznaczonym w ust. 9 na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.

lub

c. od umowy odstąpić i obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w ust.5 lit. a.

12. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, chyba, że niniejsza umowa przewiduje karę umowną w innej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3c do SIWZ

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3c do SIWZ

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust 1 pkt. 2 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy projektu umowy - dotyczy zał. nr 3c do SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu § 7 ust 3 b :

3. Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 53

Grupa 53. Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (PLIF, TLIF, ALIF)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów międzytrzonowych o 3 długościach wszczepów od 20 do 30mm, i wysokościach od 8 do 14mm, i spełniających pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 58

Grupa 58. Stabilizacja przeznasadowa do urazów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego do zastosowania w złamaniach

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu o następujących parametrach:

- Śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy od 4,5-8,5mm ze skokiem co 1 mm; śruby o długości 25-50mm dla średnicy 4,5mm oraz 25-60mm dla pozostałych średnic ze skokiem co 5 mm.

- Pręty tytanowe o średnicy 5,5mm i długości 25-70 mm ze skokiem co 5mm; pręty o długości 70-100mm ze skokiem co 10mm, 100-200mm ze skokiem co 20mm, oraz 300 i 600mm,

- Łączniki poprzeczne wieloosiowe, od 45 do 85mm;

i spełniających pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18- dotyczy grupy 26

Czy zamawiający w Zadaniu (Grupie) nr 26 dopuści przewodnik :

-wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

-długość przewodnika roboczego 185 i 300 cm,

-przewodniki do pomiaru „ z sensorem ciśnieniowym umieszczonym na szczycie przewodnika, lub oddalonym od niego o 15 mm

-końcówki "J" i prosta, średnica przewodnika 0,014 cala,

-użyczenie na okres 12 miesięcy współpracującego z przewodnikami systemu do pomiarów FFR (Fractional Flow Reserve) oraz CFR(Coronary Flow Reserve ,z pomiarami przepływu na zasadzie wykorzystania

zjawiska Dopplera, z 15" ekranem dotykowym, możliwością równoczesnego wyświetlania na ekranie wartości przepływu i ciśnienia, możliwością bezpośredniego zapisu obrazów ekranu na pendrive przez łącze USB urządzenia, nagrywarka CD-R/W i drukarką termiczną
- utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 10 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 7 cewnika, w którym lek nanoszony jest techniką Bioshell (mieszanina 1:1 paklitakselu i szelaku); o dostępnych długościach balonu: 15, 20, 25, 30mm; o ciśnieniu nominalnym 6 bar oraz ciśnieniu RBP 14 bar dla 4.0mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do PTCA uwalniające lek o ciśnieniu RBP = 13 atm. dla średnic 2.0 – 3.5 mm i 12 atm. dla średnicy 4.0 mm., bez możliwości utworzenia depozytu (wyłącznie dostawy sukcesywne)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia, jednakże Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymogu utworzenia depozytu.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie nr 22 - dotyczące zapisów SIWZ rozdział II punkt 1 akapit 7

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informacje czy do oferty ma zostać załączony projekt umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączenia projektu umowy.

Pytanie nr 23 - dotyczące zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 4 punkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczące zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 4 punkt 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczące zapisów umowy – załącznik nr 3a do SIWZ - paragraf 1 punkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczące zapisów umowy – załącznik 3a - paragraf 1 punkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu utworzenia depozytu z 7 do 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczące zapisów umowy – załącznik 3a - paragraf 2 punkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełniania depozytu z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 32

Czy Zamawiający w Grupie 32 poz. 6.2 oraz 6.3 dopuści odpowiednio zaoferowanie o-ringa do butelek (poz. 6.2) oraz zatyczki zapasowej do butelek (poz. 6.3), przy czym elementy te, nie są wyrobem medycznym i posiadają VAT 23% (nie posiadają dokumentów, o których mowa w rozdziale III punkt 3 tj. Certyfikat CE i Deklaracji zgodności MDD, Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Jednakże dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego asortyment?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 29- dotyczy grupy 52

Czy Zamawiający w Grupie 5 poz.11 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych w dwóch kolorach osłonek: szare i niebieskie, co dodatkowo pozwala na łatwe rozpoznanie długości narzędzia przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 32

Czy Zamawiający w Grupie nr 32 poz. 2 dopuści zaoferowanie zestawu protez polietylenowych w rozmiarze 7Fr, jak również protezy wykonane z EVA w rozmiarze 8,5Fr i 10Fr. Dodatkowo dla rozmiaru 10Fr minimalna średnica kanału roboczego wynosi 3,7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 32

dotyczy Grupy 32 poz. 6.1 Czy ze względu na fakt, iż najmniejsze dostępne opakowanie handlowe o-ringa do butelek typu Maj-901 zawiera 5 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w górę do pełnego opakowania handlowego tj. 5szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 50

Czy zamawiający dopuszcza w Grupie 50:

- implant zbudowany z jednej części posiadający żeberkową powierzchnię w ramionach fiksovanych do wyrostków kołczystych?

Pozostałe parametry Zamawiającego bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 54

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie nr 54:

- ręczne mieszanie cementu w specjalnym mieszalniku znajdującym się w zestawie.

- podawanie cementu za pomocą strzykawek wcześniej napełnianych za pomocą specjalnego łącznika podłączanego do pojemnika na cement

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ręcznego mieszania cementu.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 54

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie nr 54:

- Śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/-25 stopni).

- Śruby dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry (osadzanie pręta z góry).

- Długość śrub perforowanych w przedziale 35-55 mm, średnice śrub 5,2mm, 6,2mm, 7,0 mm. Do śrub perforowanych specjalne końcówki adaptujące strzykawki do aplikacji cementu, sterylne.
- Perforacja występująca na 20%—40 % długości gwintu śruby (sześć specjalnych otworów wylotowych do cementu), umożliwiającą biomechanicznie optymalną aplikację cementu i lepsze zakotwiczenie w osteoporotycznej kości.
- Blokada śruby do pręta nakrętką z góry (gniazdo śrubokręta typu „star drive”). Brak konieczności stosowania dodatkowych śrub wyciągowych do redukcji kręgozmyków. Możliwość płynnej repozycji kręgozmyku.
- Możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby).
- Możliwość przeprowadzania kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu
- W zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków w ranie operacyjnej („in situ”), dociąganie śrub do pręta, remobilizacji główek śrub. W zestawie kaniulowane narzędzia do stosowania „po drucie wprowadzającym”. W zestawie próbniaki do pedikulum (prosty, zagięty).
- Cement o podwyższonej biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.

Pytanie nr 35- dotyczy grupy 54

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie nr 54:

- Śruby transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/-45 stopni). Śruby dwurdzeniowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry (osadzanie pręta z góry w osi śruby).
- Długość śrub w przedziale 20-100mm, średnica od 4 0mm do 9,0mm mm, kodowane kolorami. Wydłużony kielich główki śruby umożliwiający stopniową korekcję „in situ”) na długim i krótkim dystansie.
- Pręty tytanowe proste i wstępnie wygięte, średnica 6,0mm. Długość prętów od 45mm do 500mm. Pręty proste, dogięte, dostępne jako twarde i miękkie.
- Blokada śrub dwustopniowa pozwalająca na przeprowadzenie oddzielnie dwóch kombinacji: utrzymanie pręta w śrubie i blokada wieloosiowości śrubyostateczne zablokowanie pręta w śrubie
- Możliwość blokowania śrub ze stałą powtarzalną siłą docisku (śrubokręt dynamometryczny 10Nm).
- Narzędzie umożliwiające odłamanie wydłużonego kielicha śruby, dystrakcję, kompresję,
- W zestawie narzędzia do derotacji trzonów kręgowych, śrubokręt dynamometryczny typu „star drive T25” z mechanizmem „ratchet”, pręt próbny, do utworzenia wzorca dla pręta właściwego.
- Łącznik poprzeczny z możliwością ustawienia kąтового względem prętów głównych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.

Pytanie nr 36 - dotyczy grupy 54

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie nr 54:

- Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne
- Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI
- Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej.
- Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia
- Klatki odtwarzające lordozę szyjną.
- W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgow szyjnych.
- Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm.
- W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza klatek wykonanych z PEEK bez metalowych radioznaników.

Pytanie nr 37 - dotyczy grupy 51

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie 51:

- Klatki anatomiczne, umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa.

- Materiał: specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) – poliwęglan
- Duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgów
- Implanty zaopatrzone w dodatkowy system kotwienia w przestrzeni międzykręgowej (karbowana powierzchnia górna i dolna).
- Implanty zaopatrzone w nieprzeziernie dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Wysokość implantów w zakresie 4-8mm (skok co 1 mm).
- implanty niesterylne

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy grupy 53

Czy Zamawiający dopuszcza w Grupie 53:

- Klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego włóknami węglowymi.
- Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ścianie przedniej i tylnej.
- Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację.
- Górna i dolna powierzchnia implantów żebrowana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru operatora.
- Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy.
- Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 12mm, 27mm, 31mm oraz 35mm.
- Implant zaopatrzony w nieprzeziernie dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne.
- Instrumentarium w kasie przeznaczonej do przechowywania i sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39 - dotyczy projektu umowy

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

2. Skreślenie § 4 ust. 17 oraz zmianę brzmienia § 4 ust. 18 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 4 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 - dotyczy projektu umowy

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 - dotyczy grupy 38

Ad.38.1 Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był całkowicie wielorazowy (autoklawowalny)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 42- dotyczy grupy 38

Ad. 38.2 Czy Zamawiający wymaga, aby posiadał możliwość ufiksowania do szyjki macicy poprzez wkręcenie wkładu roboczego oraz posiadał ceramiczne kołnierze ułatwiające odcinanie prądem monopolarnym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 38

Ad.38.3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pojemnika do sterylizacji manipulatora?

Odpowiedź:

Tak, wymaga zaoferowania pojemnika do sterylizacji manipulatora w ramach ceny oferty.

Pytanie nr 44 - dotyczy grupy 38

Ad. 38.4 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 30 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy grupy 40

Ad.40.1 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pętle laparoskopowe zamienne do histerektomii nadszyjkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy grupy 40

Ad.40.2 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 15 dni roboczych?

Odpowiedź:

Taki termin w odniesieniu do grupy 40 został ustalony w SIWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy grupy 61

Czy Zamawiający wymaga przetworników ciśnień pojedynczych z połączeniem z kablem interfejsowym bezpinowym wodoszczelnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przetworników ze złączem pasującym do kabla interfejsowego BD-Bene View.

Pytanie nr 48 - dotyczy grupy 61

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe zestawy z przetwornikiem pojedynczym o długości linii do 155cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przetworników zgodnych z opisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 49- dotyczy grupy 3

Prosimy o dopuszczenie w grupie 3 zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL z kompletem gazików bez otworów. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy grupy 30

Prosimy o wydzielenie z pakietu 3 poz 3.1 do oddzielnego pakietu i dopuszczenie igieł biopsyjnych o parametrach zgodnych z załączoną ulotką


Igła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości

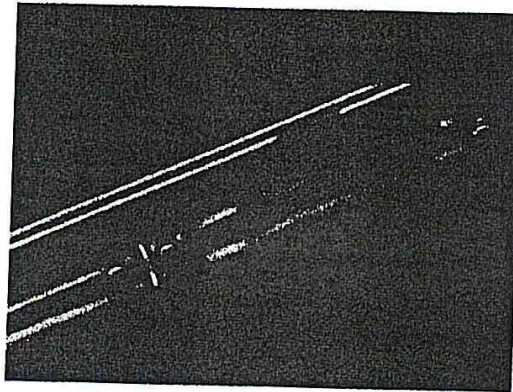

Używana z endoskopem ultradźwiękowym do biopsji cienkoigłowej (FNB) zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródtrzewnowych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego.

- Specjalnie zaprojektowana końcówka igły zwiększa wydajność pobierania próbek i sprzyja pobieraniu histologicznych próbek rdzenia
- Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości na igle daje wyjątkową widoczność igły
- Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność
- 8 cm przedłużenie igły daje duży zasięg diagnostyczny
- Pierścień zabezpieczający łatwo przesuwają się i blokuje przy żądanym przedłużeniu.
- Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki.
- Mandryn wykonany z nitinolu

Urządzenie dostarczane jest jałowe i przeznaczone do jednorazowego użytku.

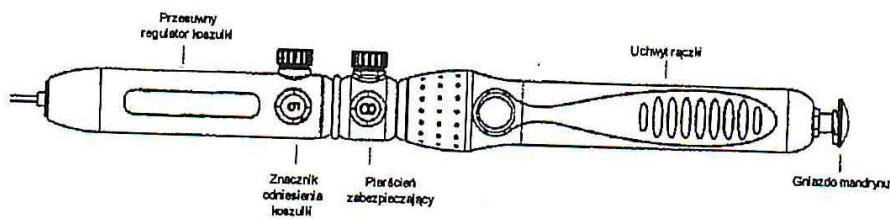

Numer katalogowy	Rozmiar igły	Ścięcie igły	Rozmiar koszulki	Nastawne przedłużenie igły	Mandryn	Zakończenie mandrynu
	19	ukośne	4,8	0 - 8	0,030	zaokrąglone
	25	ukośne	5,2	0 - 8	0,012	ścięte

Minimalny kanał dostępowy 2,0 mm. Nastawna długość koszulki (0 - 5cm). Załączona strzykawka próżniowa o pojemności 5 ml i 10 ml.

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51- dotyczy grupy 32

Prosimy o wydzielenie z pakietu 32 poz 5, 5.1, 7 i 8 do oddzielnego pakietu i dopuszczenie asortymentu o parametrach zgodnych z załączoną ulotką

Gr. 32 poz. 7


Igła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości

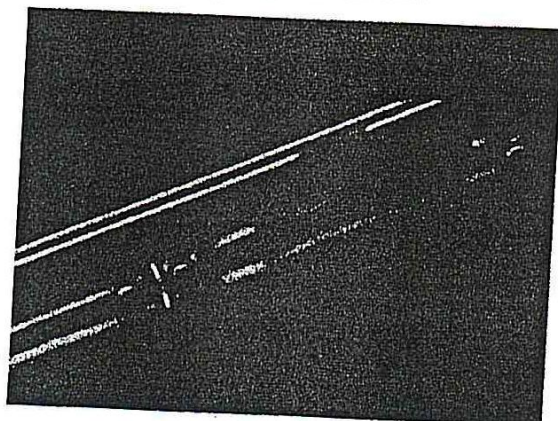

Używana z endoskopem ultradźwiękowym do biopsji cienkoigłowej (FNB) zmian podśluzówkowych, mas śródpierśia, węzłów chłonnych i mas śródtrzewnowych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego.

- Specjalnie zaprojektowana końcówka igły zwiększa wydajność pobierania próbek i sprzyja pobieraniu histologicznych próbek rdzenia
- Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości na igle daje wyjątkową widoczność igły
- Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność
- 8 cm przedłużenie igły daje duży zasięg diagnostyczny
- Pierścień zabezpieczający łatwo przesuwają się i blokuje przy żądanym przedłużeniu.
- Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki.
- Mandryn wykonany z nitinolu

Urządzenie dostarczane jest jałowe i przeznaczone do jednorazowego użytku.

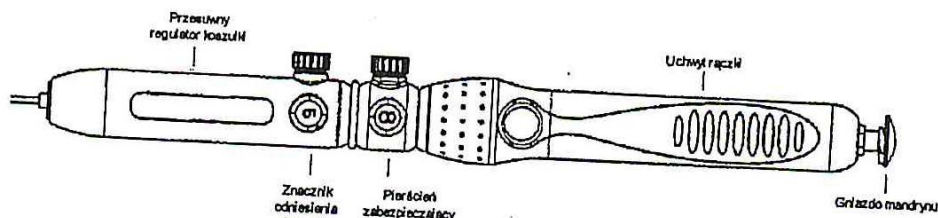

Numer katalogowy	Rozmiar igły	Ścięcie igły	Rozmiar koszulki	Nastawne przedłużenie igły	Mandryn	Zakończenie mandrynu
	19	ukośne	4,8	0 - 8	0,030	zaokrąglone
	25	ukośne	5,2	0 - 8	0,012	ścięte

Minimalny kanał dostępowy 2,0 mm. Nastawna długość koszulki (0 - 5cm). Załączona strzykawka próżniowa o pojemności 5 ml i 10 ml.

Gr. 32 poz. 5, 5.1

balon do ekstrakcji


Używany do endoskopowego usuwania kamieni z przewodów żółciowych i do wprowadzania kontrastu.

Wyrób dostarczany jest jałowy i jest przeznaczony do jednorazowego użycia.


Numer zamówienia		Opis	Średnica prowadnika
		Cewnik o długości 200cm i średnicy 6,6Fr. Średnica wypełnionego balonu 8,5, 10, 12 lub 15 mm Podawanie kontrastu powyżej balonu.	0,035 cala
		Cewnik o długości 200cm i średnicy 6,6Fr. Średnica wypełnionego balonu 8,5, 10, 12 lub 15 mm Podawanie kontrastu poniżej balonu.	0,035 cala
		Cewnik o długości 200cm i średnicy 6,6Fr. Średnica wypełnionego balonu 12, 15, 18 lub 20 mm Podawanie kontrastu powyżej balonu.	0,035 cala
		Cewnik o długości 200cm i średnicy 6,6Fr. Średnica wypełnionego balonu 12, 15, 18 lub 20 mm Podawanie kontrastu poniżej balonu.	0,035 cala

Minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm


Uwaga: Wyrób zawiera gumę z naturalnego kauczuku, która może być przyczyną reakcji alergicznych.




Porty



Strzykawka




Port Zip



Balon

gr. 32 por. 8

Prowadnik z prostą kalibrowaną końcówką

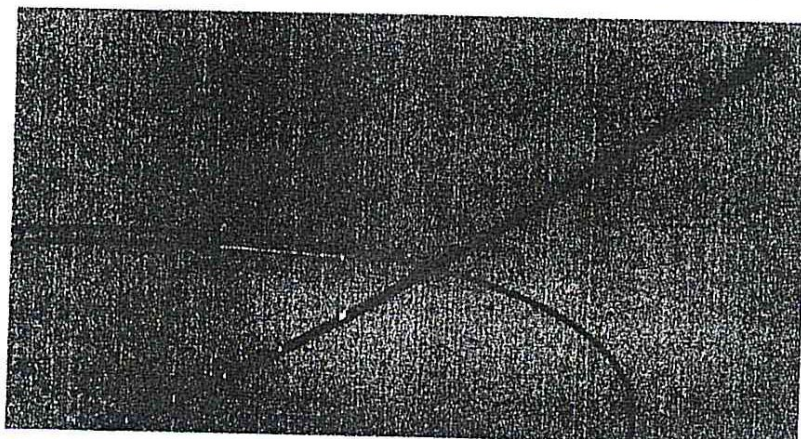

Stosowany do wspomagania kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, a także pomocy przy przejściach przez trudne zwężenia podczas wykonywania ERCP.

Struktura sprężynowego coila sprawia, że końcówka prowadnika Acrobat jest jedną z najelastyczniejszych, ułatwiając dostęp i przeprowadzanie przez najtrudniejsze zwężenia. Znaczniki endoskopowe co 5 cm od końca dystalnego wskazują ruch prowadnika i pozwalają na wymiarowanie. Hydrofilne pokrycie w dystalnej części na długości 25cm zapewnia optymalną śliskość.

Produkt dostarczany jest jałowy.
Przeznaczony do jednorazowego użytku.

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Cieniodajna kończówka	Hydrofilne pokrycie
	mm	cm	mm	cm
	0,035	205	4	25
	0,035	260	4	25
	0,035	450	4	25
	0,025	260	4	25
	0,025	450	4	25

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 - PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU UMOWY

Czy w zakresie Pakietu nr 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbrojonych cewników aspiracyjnych w tętnicach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych z powłoką hydrofilną na długości 15cm w części dystalnej kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawką zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzepin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045"; światło ssące: 0,95mm² umożliwiające przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 13 wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji w terminie określonym w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającego 3 dni robocze termin określony w ust. 2 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 5% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy w połączeniu z §4 ust. 16 wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 16 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami, Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 18 wzoru umowy na następujący: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3-krotnego przekraczającego 7 dni roboczych opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 4 ust. 19 wzoru umowy na następujący: „W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 59 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 61 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 6 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY (załącznik nr 3):

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania §7 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY DEPOZYTU (załącznik nr 3a):

Prosimy Zamawiającego w zakresie pakietów 14, 15, oraz 18 zmniejszenie ilości sztuk asortymentu będącego w depozycie do 5 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 - PYTANIA DOT. WZORU UMOWY DEPOZYTU (załącznik nr 3a):

Prosimy Zamawiającego o zmianę kary umownej w §1 ust. 5 wzoru umowy depozytu na 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65- dotyczy grupy 61

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy jednorazowe zestawy z przetwornikiem, amerykańskiego producenta firmy, które ze względu na wysoką jakość i konstrukcję nie wymagają odrębnego eliminatora rezonansów magnetycznych, przy spełnianiu pozostałych parametrów wymaganych przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 66 - dotyczy grupy 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego rozwiązania w grupie numer 59 o poniższych parametrach:

- Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, zaokrąglona część przednia. Materiał PEEK.
- Rozmiary koszyków: szerokości 13mm, 15mm, wysokość 4 - 9 mm stopniowane co 1mm. - Obecność na powierzchni styków koszyków ostrych karbów zapobiegających wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej.
- Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów.
- Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych znaczników radiologicznych (min. 3) widocznych w promieniowaniu RTG.
- Dostarczany osobno jałowy gotowy do użycia syntetyczny substytut kostny na bazie hydroksyapatytu w formie pasty dostępny w opakowaniach po 1cc.
- Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.
- Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków z implantami próbnymi odpowiadającymi wszystkim rozmiarom klatek.
- Aplikator do klatek prosty, łączony od przodu z klatką i z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 67 - dotyczy grupy 59

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia implantów w grupie 59 w sterylnych opakowaniach przydatnych do użycia przynajmniej 12 miesięcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 - dotyczy grupy 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie narzędzi od niemieckiego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie dla grupy 36.

Pytanie nr 69 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

z jakiego rodzaju stopu tytanowego mają być zaciski,

Odpowiedź:

Zaciski powinny być wykonane ze stopu tytanowego zgodnego z normami przewidzianymi dla zacisków płyta czaszki w obrębie Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej.

Pytanie nr 70 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

jaki system zapadkowy winny one posiadać,

Odpowiedź:

Powinny posiadać system zapadkowy ze sprężyną płaską.

Pytanie nr 71 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

czy one mają być na ryflowym trzpieniu,

Odpowiedź:

Powinny być na ryflowym trzpieniu zapewniającym stabilniejsze mocowanie płyta.

Pytanie nr 72 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

czy dopuszczalne są zaciski dające minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli,

Odpowiedź:

Zaciski powinny dawać minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli.

Pytanie nr 73 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie: jakie mają być średnice zacisków,

Odpowiedź:

Wymagane średnice zacisków: 11mm, 16 mm, 20 mm.

Pytanie nr 74 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

-jak skonfigurowany winien być system aplikatorów dedykowany zaciskom,

-czy aplikatory winny zostać dostarczone w kontenerze zaopatrzonym w barierę mikrobiologiczną wielokrotnego użytku, a jeśli tak, to jakie są oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie,

Odpowiedź:

Wymagana konfiguracja zestawu

- aplikator, nierozbieralny z automatycznym (dynamometrycznym) dociąganiem
- kleszczyki podtrzymujące
- kleszczyki do obcinania
- kleszczyki do zdejmowania zacisków
- całość instrumentarium umożliwiające jego smarowanie olejem do narzędzi
- aplikatory powinny być dostarczone w kontenerze zaopatrzonym w barierę mikrobiologiczną wielokrotnego użytku w postaci wymiennego filtra z PTFE na min. 5000 cykli sterylizacyjnych.

Pytanie nr 76 - dotyczy grupy 60

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia w Grupie 60, w następującym zakresie:

czy dostarczone przez Wykonawcę implanty winny być również kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium do mocowania przedmiotowych implantów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompatybilności zacisków z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium do mocowania przedmiotowych implantów. Zamawiający posiada instrumentarium produkcji Aesculap.

Pytanie nr 77

Dotyczy Grupy 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 12 stentu stalowego uwalniającego lek Biolimus A9 z biodegradowalnego polimeru, zamontowanego na cewniku balonowym o ciśnieniu nominalnym 6 atm, o długości systemu wprowadzającego 142cm, profilu przejścia 0.018'' ,średnicy szafu dystalnego 2.6F-2.8F, kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 5F dla średnic 2.25-3.0mm, oraz z cewnikiem 6F dla średnic 3.5-4.0mm ? (wszystkie pozostałe parametry bez zmian)

Oferowany przez nas stent posiada natomiast dodatkowe długości 33 i 36mm i średnicę 4.0mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający