



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/05/P/16

Bydgoszcz, dnia 01.04.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i zestawów medycznych, protez naczyniowych, materiałów i narzędzi używanych w artroskopii i endoskopii oraz innego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych.

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 23.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy artroskopowej o następujących parametrach:

- zakres regulacji ciśnienia roboczego 30- 150mmHg

- zakres regulacji przepływu 0-2000 ml/min.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie trokaru o dł. roboczej 95 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie trokaru o dł. roboczej 98 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie trokaru o dł. roboczej 98 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie trokaru gwintowanego, nieperforowanego o śr. 11 mm i dł. roboczej 105 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 330 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 330 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 330 mm, szczęki nie ząbkowane, kolor stalowy, nieutwardzane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie elektrody monopolarnej jedno elementowej w kształcie litery „J” nie wymiennej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 330 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie endorozpieracza trójpalczastego z dostosowującym się wachlarzem rozsuwanym poprzez obrót rękojeści chowany w ten sam sposób o dł. 390 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 14

Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 330 bez kanału do płukania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 330 bez kanału do płukania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o wym. szczęk 7 mm i dł. 330 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 17

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o szczękach lekko zagiętych o dł. 330 mm względnie kleszczyków Mixer zagiętych pod kątem 90 st. i dł. 330 mm/. Prosimy sprecyzowanie czy Zamawiający Wymaga zaoferowania kleszczyków z rękojeścią z blokadą czy bez blokady.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga kleszczyków bez blokady.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe. Poz. 18

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania ssaka z uchwytem pistoletowym jeżeli nie prosimy o dopuszczenie ssaka o dł. 400 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający nie wymaga takiego uchwytu.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 18. Narzędzia laparoskopowe.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 roboczych dni od dnia złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 30 dni roboczych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 17 wzoru umowy na następujące: „Poza innymi przypadkami przewidzianymi umową lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku powtarzającej (trzykrotnej) się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku

powtarzających się reklamacji, a także w przypadku przekraczającej 5 dni roboczych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu użyczenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 1 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Zszywki ze stopu tytanu. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 2 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Zszywki ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 2 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zszywki ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 3 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Zszywki ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 3 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zszywki ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 4 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 13

Czy zamawiający dopuści w Grupie 13 pozycji 4 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 26 - dotyczy projektu umowy Załącznik nr 3A

Prosimy o odstąpienie utworzenia depozytu dla grupy 13 [zapis umowy § 1 ust. 3]

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy projektu umowy Załącznik nr 3A

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 6 ust. 7a i b na:

W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania jego obowiązków zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji,

jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3% **wadliwej dostawy** brutto obejmującej wadliwy przedmiot dostawy.

lub

b. żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % **wadliwej dostawy** brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy, za każdy dzień **zwłoki**.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń o gramaturze wyższej niż opisana w przedmiocie zamówienia, chłonności 512% dla włókniyny dwuwarstwowej i odporności na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O?


Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń w składzie:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przylepna serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem przylepnym „U” 20 x 100 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

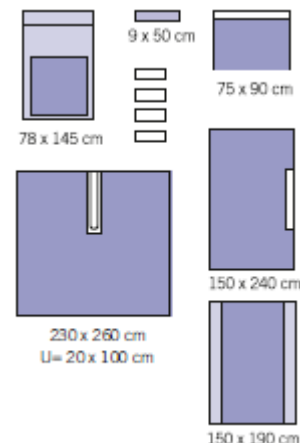


Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

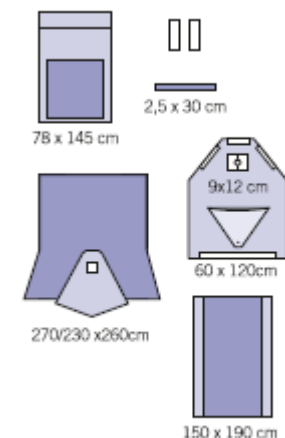

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 3

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby serwety główne w zestawie uniwersalnym nie zawierały celulozy, powodującej znacznie większe pylenie w porównaniu z materiałami bez dodatku celulozy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 10

Prosimy o możliwość złożenia oferty z protezami z jednostronnym welurowaniem zewnętrznym, które sprzyja wgajaniu się protezy. Welurowanie wewnątrz nie niesie ze sobą dodatkowych korzyści dla pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 11

Prosimy o możliwość złożenia oferty z protezami z jednostronnym welurowaniem zewnętrznym, które sprzyja wgajaniu się protezy. Welurowanie wewnątrz nie niesie ze sobą dodatkowych korzyści dla pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych wkładów workowych na wydzielinę o pojemności 1000ml; 2000ml oraz 3000ml jako równoważnych do wymaganych 1500ml i 2500ml. Wkłady wyposażone w uchwyt umożliwiający obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Wszystkie pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

Jednocześnie prosimy o podanie ilości stanowisk jakie posiada Zamawiający. Jest to związane z tym, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, będziemy zobowiązani do nieodpłatnego dostarczenia i wyposażenia tych stanowisk w niezbędny, kompatybilny z wkładami workowymi sprzęt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy § 4 ust. 13 wzoru umowy

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informację, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 16. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 13 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 4 ust. 15.

Dotyczy § 4 ust. 15 wzoru umowy

„W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki”. Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczętą dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy § 4 ust. 17 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37 - dotyczy § 4 ust. 18 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem o zmniejszenie kar do wysokości 10% i naliczanie tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający w grupie nr 13 poz. 1 dopuści stapler z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1,0-2,0mm o wysokości zszywki 5,0mm (dla średnicy 21mm wysokość zszywki 4,2mm) ze sztywną główką. Dla średnicy 25mm wykonawca zaoferuje również sztywną główkę w kształcie pełnego stożka prostego ułatwiającą wprowadzenie główki w światło przełyku. Zgodnie z SIWZ dla każdej średnicy zaoferowane zostaną także staplery w wersji przedłużonej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39 - dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający w grupie nr 13 poz. 2 dopuści stapler liniowy jednorazowy tnący ze zintegrowanym nożem o długości linii zespolenia 61mm i 81mm z jednostronna dźwignia aktywująca?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40 - dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający w grupie nr 13 poz. 3 dopuści ładunki o długości zespolenia 61mm i 81mm kompatybilne ze staplerem z pozycji 2?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41 - dotyczy grupy 13

Czy Zamawiający w grupie nr 13 poz. 4 dopuści stapler o długości linii zespolenia 32mm, 46mm i 60mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42 - dotyczy grupy 13

Czy w grupie nr 13 poz. 4 Zamawiający wymaga aby stapler 30mm był dostępny również ze zszywką zamykającą na 1,0mm (przez zamknięciem 2,5mm). Dodatkowa wysokość zszywki daje możliwość lepszego doboru narzędzi do sytuacji w polu operacyjnym. Jednocześnie wprowadzenie dodatkowej wysokości zszywki nie wpływa w żaden sposób na parametry sprzętu opisanego w SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 13

Zgodnie z punktem 3.5 do SIWZ dla grupy nr 13 do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie wymagane parametry i konfigurację przedmiotu zamówienia (np. karty techniczne, katalogi...). Na podstawie wymienionych w tym punkcie dokumentów Zamawiający nie będzie miał możliwości zweryfikowania, czy zaoferowany wyrób spełnia wszystkie stawiane przez Zamawiającego wymagania. Weryfikacja części parametrów możliwa jest tylko po obejrzeniu narzędzi. Czy w związku z powyższym Zamawiający w grupie nr 13 dopuszcza możliwość, **w przypadku wystąpienia wątpliwości** co do zaoferowanego asortymentu, do wezwania oferentów w trakcie sprawdzania i oceny ofert, do złożenia pojedynczych sztuk, wskazanych przez Zamawiającego narzędzi, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 44 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu dot. wzoru umowy § 4 na następujący:

W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu dot. wzoru umowy § 4 na następujący:

W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy grupy 1, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści serwety dodatkowo z nitką radiacyjną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy grupy 2, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści, aby w pakiecie brzuszno-krocowym strzykawka Janeta była o pojemności 100ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również strzykawkę Janeta była o pojemności 100ml

Pytanie nr 48 - dotyczy grupy 2, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści, aby w zestawie do zabiegów artroskopii kolana znajdowały się 2szt. fartuchów chirurgicznych wzmocnionych w rozmiarze XL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 49 - dotyczy grupy 2, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści, aby w zestawie do histeroskopii okno w okolicy krocza w serwecie ginekologicznej miało rozmiar 10cm x 15cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 51 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była ponad dwa razy wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 52 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 53 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 lit. c) wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) wyrażenie „15% wartości brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (grupy), nie zaś od wartości całej umowy (grupy). W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (grupy), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (grupy). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 lit. a) i b) wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) wyrażenie „całkowitej wartości brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przekroczenie terminu usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad była naliczana od wartości towaru wadliwego, nie zaś od wartości całej grupy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet może przewyżścić tę wartość. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 55 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 3A do SIWZ) został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 56 - dotyczy grupy nr 13

Czy Zamawiający wymaga aby w grupie 13 wszystkie zaoferowane staplery posiadały zszywkę bilateralnie spłaszczoną na całej długości drutu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 57 - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 20 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie optyk laparoskopowych z system soczewek wałeczkowych, o dł. 310mm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 58 - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 20 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie kosza na optyki o wymiarach 446 x 49 x 88 mm, kompatybilnego z oferowanymi optykami?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 59 - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 20 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie światłowodu o średnicy wiązki 4,25mm i długości 3m, przeznaczonego do optyk o dużej średnicy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3A do SIWZ - paragraf 4 punkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 61 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 4 punkt 15

Czy Zamawiający wyrazi na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy lub jej części?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 62 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 4 punkt 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10 % w przypadku rozwiązania w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 63 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 6 punkt 7a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1 % ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 64 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 6 punkt 7c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10 % ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 65 - dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - paragraf 8 punkt 4c: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie w umowie zapisu „w okresie obowiązywania umowy stale pozostają ceny netto, zaś ceny brutto zmieniają się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 66 - dotyczy zapisów SIWZ:

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informacje czy do oferty ma zostać załączony projekt umowy ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów zgodnych z zapisami SIWZ w rozdziale III. Zamawiający nie wymaga załączenia projektu umowy.

Pytanie nr 67 - dotyczy zapisów SIWZ

Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z wpisem do KRS Zamawiający figuruje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową ani nie została wszczęta procedura likwidacji.

Pytanie nr 68 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 1:

- Kleszcze artroskopowe typu Punch, niski profil, śr. 3.4mm, proste zagięte ku górze pod kątem 15 stopni, dł. rob. 130 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 69 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 1:

- Kleszcze typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie, płaszczy zakrzywiony ku górze 15°, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm, wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszczy 3,4 mm, długość robocza 120 mm, konstrukcja płaszczy otwarta, ciągnie prowadzone w górnej części płaszczy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 70 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 2:

- Cążki z ruchomą częścią uzębioną, szerokość formy 4,5 mm, śr. płaszczy 3,4 mm, wygięte w górę 15 stopni, dł. robocza 130 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 71 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 3:

- Kleszcze typu punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki płaskie zakrzywione ku górze, wymiary cięcia 5,5 mm x 3,3 mm, wysokość szczęk 1,6 mm, średnica płaszczy 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszczy otwarta, ciągnie prowadzone w górnej części płaszczy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 72 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 3:

- Kleszcze typu punch, uzębiona część ruchoma, szerokość formy 4,5 mm, szczęki wygięte w górę 15 stopni, średnica płaszczy 4,5 mm, dł. robocza 130 mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 73 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu hook punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 4:

- Kleszcze typu hook punch, średnica płaszczy 3,4mm, wygięte w górę 15 stopni, dł. robocza 130 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 74 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu hook punch ,równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 4:

- Kleszcze typu hook punch do trudnodostępnych miejsc, szczęki zakrzywione ku górze, bransze o wysokości 1,6 mm, wymiary cięcia 3,1 mm x 1,7 mm, średnica płaszczy 3,4 mm, długość robocza 120 mm Konstrukcja płaszczy otwarta, ciągnie prowadzone w górnej części płaszczy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 75 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści kleszcze artroskopowe typu grasper alligator, równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 5:

- Grasper typu alligator, uchwyt z blokadą, dodatkowo końcówka z oczyszczaniem zazębienia, płaszcz średnica 3,4 mm, długość robocza 130 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 76 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści narzędzie do mikrozlamań, równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 6:

- Mikrofraktor wygięty 30°; dł. robocza 170mm, Znacznik prawidłowej penetracji w postaci mikro wyżłobienia umieszczony 3mm od ostrego zakończenia szpikulca, Uchwyt ergonomiczny, gumowy antypoślizgowy zapewniający pewny chwyt instrumentu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 77 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści haczyk artroskopowy, równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 7:

- Sonda hakowa, znakowana, do łękotki, dł. robocza 115, wysokość części hakowej 7 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 78 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści haczyk artroskopowy, równoważne do opisanego w SIWZ w punkcie 7:

- Sonda hakowa, znakowana, do łękotki, dł. robocza 115, wysokość części hakowej 4.5 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 79 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający dopuści dwa narzędzia artroskopowe jedno do obcinania szwów nici i drugie jako spychacz do węzłów, równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie 8:

- Obcinak artroskopowy do nici poliestrowych (PET) odpornych na rozrywanie, dł. rob. 200 mm.

- Spychacz „aplikator” do węzłów, dł. rob. 170 mm, zew. śr. 3.4 mm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 80 - dotyczy grupy 21

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 81 - dotyczy grupy 23

Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe pacjent-pompa, opcjonalnie dreny dobowe, oraz pompę artroskopową w postaci użyczenia, równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie 8:

Pompa artroskopowa użyczana zamawiającemu o następujących parametrach:

Pompa artroskopowa wyposażona w funkcję ssania.

Cechy:

- komunikaty i obsługa menu urządzenia w języku Polskim,
- możliwość ustawienia nominalnego ciśnienia w zakresie 15 – 200 mmHg,
- możliwość nastawienia przepływu w zakresie 0.1 – 2 l/min,
- funkcja płukania stawu,
- współpraca jednorazowymi, i dobowymi,
- pompa wyposażona w ssak (ssanie na zasadzie wytworzenia podciśnienia w pojemniku na płyny),
- duży dotykowy kolorowy wyświetlacz
- 3 profile pracy (kolano, bark, małe stawy),
- możliwość wprowadzenia do 16 profili użytkowych w pamięci urządzenia,
- maks. ujemne ciśnienie ssania wynoszące 60 kPa
- maks. ssanie 2 l/min
- wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie aktualnego ciśnienia i aktualnego przepływu
- możliwość płynnej zmiany wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym
- możliwość zmiany ciśnienia z krokiem co 10 mmHg poprzez dłuższe przyciśnięcie (powyżej 1.5 sec) znaku + lub – na ekranie dotykowym
- możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym
- pompa posiadająca funkcję „wash” szybkiego płukania stawu w przypadku trudnych warunków operacyjnych

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 82 - dotyczy grupy 23

Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe pacjent-pompa, opcjonalnie dreny dobowe, oraz pompę artroskopową w postaci użyczenia, równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie 8:

Zestaw drenów jednorazowych (1 op. zawiera 10 sztuk) z przebijkami, pakowane sterylne, możliwość podłączenia do dwóch worków z płynem infuzyjnym.

Ilość zgodnie z siwz tj. 60 op. = 600 szt.(pakowane sterylne)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 83 - dotyczy grupy 23

Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe pacjent-pompa, opcjonalnie dreny dobowe, oraz pompę artroskopową w postaci użyczenia, równoważne do opisanych w SIWZ w punkcie 8:

Opcjonalnie możliwość użytku drenów dobowych przy większej ilości operacji w ciągu dnia. Zestaw dobowy przeznaczony do 10 zabiegów w ciągu 24 h (10x dren jednorazowy pacjenta i 1 x dren dobowy z przebijkami, pakowane sterylne).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 84 - dotyczy grupy 23

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy pompy do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 85 - dotyczy grupy 20 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Kosze zgodne z zapisami SIWZ, ale o wymiarach 477x54x355 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 86 - dotyczy grupy 20 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki z wałeczkowym układem soczewek i pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ, ale o długości 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 87 - dotyczy grupy 18 Poz. 1-2 oraz 4-5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania trokary zgodne z zapisami SIWZ, ale o długości roboczej 100mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 88 - dotyczy grupy 18 Poz. 8-10, 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia zgodne z zapisami SIWZ, ale o długości roboczej 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 89 - dotyczy grupy 18 Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia zgodne z zapisami SIWZ, ale o długości roboczej 340mm i bez wymiennej końcówki? W zamian proponujemy dostawę 2szt danego narzędzia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 90 - dotyczy grupy 18 Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania retractora trójpalczastego o średnicy 5mm i długości roboczej 320mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 91 - dotyczy grupy 18 Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie nożyczki monopolarne, typ Metzenbaum, obie bransze ruchome, obrotowe, rozbiegające na 3 części, wielorazowego użytku, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę o długości 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem że końce będą utwardzone.

Pytanie nr 92 - dotyczy grupy 18 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie o długości 330mm i długości bransz 20mm oraz pozostałych

parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 93 - dotyczy grupy 18 Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie o długości 330mm i zagięciu końcówki około 90 stopni (producent nie podaje dokładnego parametru)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 94 - dotyczy grupy 18 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzie o długości roboczej 310mm oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 95 - dotyczy grupy 20

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 96 - dotyczy grupy 18

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 97 - dotyczy grupy 18

Czy w Grupie nr 18 Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia próbek? Sprzęt, którego wymaga Zamawiający jest sprzętem drogim, a same próbki to bardzo duży koszt, który Wykonawca będzie musiał wliczyć w cenę, a to z kolei znacznie podwyższy wartość oferty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 98 - dotyczy grupy 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 8 w pozycji 1 i 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60 cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 99 - dotyczy grupy 10 i 11

Prosimy o dopuszczenie w grupie 10 i 11 protez wykonanych z poliestru, bez impregnacji jonami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powłoczenia protezy antybiotykiem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 100 - dotyczy grupy 10 i 11

Prosimy o dopuszczenie w grupie 10 i 11 techniki impregnacji przy użyciu aldehydu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 101 - dotyczy grupy 20 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Kosze zgodne z zapisami SIWZ, ale o wymiarach 59x471x54 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 102 - dotyczy grupy 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet zawierającego serwetę na stolik Mayo złożoną w sposób standardowy. Pozostałe parametry obłożenia zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 103 - dotyczy grupy 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm składana standardowo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta 125x150cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6,5x40cm
- 1 serweta przylepna 200x200cm,
- 1 serweta przylepna 75x75cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 104 - dotyczy grupy 3, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo składana standardowo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
- przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie szerokości warstwy lepnej dookoła okna.

Pytanie nr 105 - dotyczy grupy 3, poz. 1-3, wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów z włókniny dwuwarstwowej o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 106 - dotyczy grupy 3 poz. 1-3, wymagane parametry

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów z włókniny dwuwarstwowej o chłonności min. 900% w strefie krytycznej oraz min.300% w strefie poza krytycznej

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 107 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii, metalowy o długości kaniuli 95mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 108 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii, metalowy o długości kaniuli 95mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 109 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii o średnicy 11mm, dedykowany do narzędzi o średnicy 10mm, metalowy o długości kaniuli 100mm, z oddzielną redukcją na 5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 110 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii o średnicy 11mm, dedykowany do narzędzi o średnicy 10mm, metalowy o długości kaniuli 100mm, z oddzielną redukcją na 5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 111 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw akcesoriów wymiennych do oferowanych trokarów 11mm z pozycji 4 i 5?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 112 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki preparacyjne Maryland o długości 330mm, reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 113 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki jelitowe, okienkowe (typ Dorsey) o dł. 330mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 114- dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki Metzenbaum, obie bransze ruchome, czarne, obrotowe, rozbieralne na 4 części, wielorazowego użytku, bransze gładkie i utwardzone wkładką węglową TC, końce zakrzywione, średnica 5mm, długość 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 115 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną elektrodę monopolarną haczykową typu J z wymienną końcówką, długość 320mm lub czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednoczęściową elektrodę monopolarną haczykową typu J, nierozbieralną o długości 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 11 równoważną elektrodę monopolarną haczykową typu J z wymienną końcówką, długość 320mm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 116 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki chwytające Grasper typu CLINCH bez potwierdzenia atraumatyczności w karcie katalogowej, okienkowe, z ząbkami na obu branszach, obie bransze ruchome, rękojeść z blokadą, narzędzie 4 częściowe, średnica 5mm, dł. 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem że zastosowanie ma obowiązek przedłożenia dokumentu, o którym mowa w SIWZ – Rozdział III pkt 3, ppkt 3.6 tzn. potwierdzającego wszystkie wymagane parametry i konfiguracje przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 117 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny endorozpieracz pięciopalczasty z elastycznym wachlarzem rozsuwanym i składanym poprzez przekręcenie pierścienia w rękojeści, średnica 10mm, długość 390mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 118 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z wielostopniowym i precyzyjnym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza utwardzona wkładką węglową TC, wyposażone w kanał do płukania, rękojeść wykonana z aluminium pokrytym teflonem, średnica 5mm, dł. 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 119 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne imadło odgięte w prawo, rękojeść w osi narzędzia, z wielostopniowym i precyzyjnym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza utwardzona

wkładką węglową TC, wyposażone w kanał do płukania, rękojeść wykonana z aluminium pokrytym teflonem, średnica 5mm, dł. 330mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 120 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści równoważne kleszczyki laparoskopowe, biopsyjne, śr. 5mm, dł. 330mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 121 - dotyczy grupy nr 18 – Narzędzia laparoskopowe

Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze preparacyjne typu Overholt o nazwie własnej Mixer, zakrzywione pod kątem 90 stopni, średnica 10mm, dł. 330mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 122 – dotyczy grupy nr 20 – Optyki laparoskopowe i światłowody

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne optyki laparoskopowe w systemie HD z równoważnym układem soczewek waleczkowych bez nazwy własnej ponieważ nazwa Hopkins jest zastrzeżoną nazwą handlową dla firmy Karl Storz, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 123 – dotyczy grupy nr 20 – Optyki laparoskopowe i światłowody

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny kosz do sterylizacji optyk o wymiarach 460x80x52mm lub równoważny kontener aluminiowy, perforowany, do sterylizacji optyk o wymiarach 450x70x70mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 124 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 3), oraz udostępnienia (dot. § 5), których wzory przesyłamy w załączeniu? Projekt załączony w formie pdf.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 125 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 126 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15, 18:

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego części przedmiotu umowy

18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 127 – dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 7

7. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo:

a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania jego obowiązków zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% niezrealizowanej części wartości brutto

grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy, zgodnie z formularzem oferty dla danej grupy;
lub

b. żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części wartości brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy, zgodnie z formularzem oferty dla danej grupy, za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a-c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego,

c. po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy odstąpić od niezrealizowanej części umowy w zakresie grupy obejmującej wadliwy przedmiot umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto grupy obejmującej wadliwy przedmiot dostawy, zgodnie z formularzem oferty dla danej grupy,

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 128 – dotyczy Grupa 7 ; poz. 1.

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga dostarczania protez w rozmiarach :

4 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm , 10 mm , 12,5 mm , 15 mm oraz możliwości zamówienia protez z dodatkowym większym (trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza protezy w rozmiarach 6 mm, 8 mm , 10 mm , 12,5 mm oraz protezy z dodatkowym większym (trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 129 – dotyczy Grupa 23 – Dreny jednorazowe, pacjent-pompa artroskopowa:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem LCD do sterowania wszystkimi parametrami o przekątnej ekranu 5,7 cala o zakresie regulacji ciśnienia w trybie artroskopowym 5-150mmHg, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 130 – dotyczy grupy 18 –narzędzia laparoskopowe, poz.4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania takiego samego trokara do endoskopii tylko śr. 11mm zamiast 10mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 131 – dotyczy grupy 18 –narzędzia laparoskopowe, poz. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania takich samych narzędzi laparoskopowych tylko dł. 330mm zamiast 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Pytanie nr 132 – dotyczy grupy 18 –narzędzia laparoskopowe, poz.11

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie takiej samej monopolarnej elektrody haczykowej tylko jednoelementowej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 133 – dotyczy grupy 18 –narzędzia laparoskopowe, poz.13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie endorozpierzacza pięciopalczastego z elastycznym wachlarzem rozsuwanym za pomocą pokręteł umieszczonych na rękojeści, oraz dopuszczenie dł.380mm lub 450mm.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 134 - dotyczy grupa 20 poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę dł. 350 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Zamawiający