



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA  
W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

***Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia***

ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, **52/36-55-296**, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/62/P/13

Bydgoszcz, dnia 14.08.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego,

**Wszyscy Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

*Pytanie nr 1 - Grupa 10 poz. 1-3*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej grupie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 2 - Grupa 10 poz. 1-3*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej grupie rękawic teksturowanych na palcach.*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

*Pytanie nr 3 - Grupa 11 poz. 1-4*

*Prosimy o podanie czy powyższe mankiety mają być jedno czy dwużyłowe?*

*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający wymaga mankietów jednożyłowych.

*Pytanie nr 4 - Grupa 11 poz. 1-4*

*Zwracamy się z prośbą o podanie czy mankiety j.u. mają być wyposażone w standardowe konektory/ wtyczki jak na załączonym rysunku?*



*Odpowiedź na zapytanie:*

Zamawiający wymaga mankietów wyposażonych w standardowe konektory.

Pytanie nr 5 - Grupa 25 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach papierów do USG kompatybilnych (nieoryginalnych) z powodzeniem stosowanych w wielu szpitalach.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 6 - Grupa 27 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższe pozycji papieru o rozmiarze 210mm x 280mm x 240 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 81 bloków.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 7 - Grupa 63 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości na palcach 0,16-0,18 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8 - Grupa 63 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o sile zrywającej min 9N przed starzeniem, zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Grupa 63 poz. 1-6

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rozmiar rękawicy był naniesiony bezpośrednio na rękawicę. Wymóg ten nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym, oraz na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym rękawic chirurgicznych jest standardowo naniesiony rozmiar rękawic, także użytkownik ma całkowitą pewność, z jakiego rozmiaru rękawic korzysta. Ponadto wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - Grupa 76 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości na palcach 0,21  $\pm$  0,02 (mm), zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - Grupa 76 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie AQL  $\leq$  1,0, zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 - Grupa 76 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o sile zrywającej min 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu, zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 - Grupa 76 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach rękawice pakowane podwójnie w wewnętrzne opakowanie papierowe i zewnętrzne papierowe podfoliowane?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób pakowania rękawic.

Pytanie nr 14 - Dotyczy SIWZ rozdział III pkt 3.7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie zapisu dotyczącego prawa o wezwanie o próbki w ilości min. 1 sztuki z każdej grupy. Czy w przypadku pakietu/ grupy podzielonego na pozycje, gdzie asortyment różni się jedynie rozmiarem wezwanie o próbki będzie dotyczyć tylko jednej sztuki asortymentu.

Np. Grupa 11 składa się z 4 pozycji ( ten sam asortyment tylko 4 różne rozmiary)- w przypadku wzywania o próbki Zamawiający wzywa o jedną sztukę próbki dowolnego rozmiaru?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony Zamawiającego dotyczących oceny zgodności oferowanego asortymentu z parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na piśmie o dostarczenie próbek ( w ilości min. 1 sztuka z każdej grupy ), tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia wymaganych ilości szt. rękawic z każdej z grup.

Pytanie nr15 - Projekt umowy - §4 ust. 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie lub reklamowanego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16 - Projekt umowy - §4 ust. 18

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 4 ust 18 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17 -Projekt umowy - §7 ust. 1 pkt. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto i wartość brutto umowy (stosownie obniżeniu lub podwyższeniu), natomiast wartość netto umowy pozostanie bez zmian.

W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18

W pakiecie nr 73 ( paski do glukometrów + glukometry ) Zamawiający wymaga aby system pomiarowy spełniał z normę ISO 15197:2003 oraz Zalecenia PTD . Informujemy, iż zalecenia dokładności PTD są znacznie bardziej restrykcyjne aniżeli normy ISO 15197:2003. Chcieliśmy się upewnić czy Zamawiający podtrzyma ten wymóg i nie dopuści systemów pomiarowych , które nie spełniają zaleceń PTD tj. : Deklarowany błąd oznaczania nie przekracza 15% dla stężeń glukozy  $\geq 100$  mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy  $< 100$  mg/dl (5,6 mmol/l) – czyli Zamawiający dopuści tylko taki system pomiarowy , którego dokładność mieści się w granicach  $\pm 15\%$  w stosunku do urządzenia referencyjnego ( 100 % wyników w strefie A siatki błędów Clarke'a ). Prosimy o precyzyjną odpowiedź ponieważ w ofercie posiadamy kilka modeli glukometrów w różnych cenach i o różnym standardzie dokładności i precyzji pomiaru.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający określił wymagania dotyczące glukometrów i pasków oraz zawarł wymóg dostarczenia dokumentacji potwierdzającej jakość analityczną oferowanego systemu pomiarowego spełniającego standardy normy ISO 15197:2003 oraz aktualne zalecenia PTB.

Pytanie nr 19

*W pakiecie nr 73 (paski do glukometrów + glukometry) Zamawiający wymaga aby system pomiarowy umożliwiał badanie stężenia glukozy we krwi noworodków ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zamierza wykorzystywać glukometry na wszystkich oddziałach szpitalnych w tym również na oddziale noworodkowym i oddziale hematologii – dlatego oczekuje dołączenia do oferty wykazu czynników mogących zakłócać pomiar glukozy (w tym podania zakresu korekty hematokrytu). Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymogu w zakresie współczynnika korekty hematokrytu wynoszącego 10-70%.

Pytanie nr 20

*W pakiecie nr 73 (paski do glukometrów + glukometry) Zamawiający wymaga aby system pomiarowy charakteryzował się szerokim współczynnikiem korekty hematokrytu wynoszącym 10-70 % ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zamierza wykorzystywać glukometry na wszystkich oddziałach szpitalnych w tym również na oddziale noworodkowym i oddziale hematologii – dlatego oczekuje dołączenia do oferty wykazu czynników mogących zakłócać pomiar glukozy (w tym podania zakresu korekty hematokrytu). Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymogu w zakresie współczynnika korekty hematokrytu wynoszącego 10-70%.

Pytanie nr 21

*W pakiecie nr 73 (paski do glukometrów + glukometry) Zamawiający dopuści test paskowy, którego pole pomiarowe znajduje się w części bocznej co utrudnia lub uniemożliwia nanoszenie próbki krwi z innych miejsc niż opuszek palca ( np. próbówka, naczynko ) ?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, gdzie określił wymagania dotyczące glukometrów i pasków.

Pytanie nr 22


*W pakiecie nr 73 (paski do glukometrów + glukometry) Zamawiający wymaga aby pole pomiarowe znajdowało się w przedniej części paska co ułatwia nanoszenie próbki krwi z innych miejsc niż opuszek palca ( np. próbówka ) ?*

Poniżej podajemy graficzny przykład testów paskowych z podziałem na przedni i boczny sposób nakładania kropli krwi :

Przykład testu z „przednim”  
polem pomiarowym :



Przykład testu z „bocznym”  
polem pomiarowym :

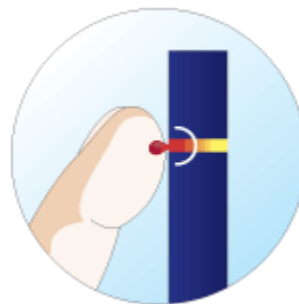

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, gdzie określił wymagania dotyczące glukometrów i pasków

Pytanie nr 23 - Dotyczy zapisu Umowy § 7 – Postanowienia końcowe

*Pkt. 2 Zmiany określone w ust. 1 nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą ceny jednostkowej lub wartości umowy.*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.*

*Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.*

*Prosimy o zmianę zapisu umowy na: „Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności niniejszej umowy i nie będą podlegać zwiększeniu, za wyjątkiem znaczących:*

*a) Zmian stawek podatkowych*

*W przypadku zmiany stawek podatku VAT ceny brutto zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy (cena netto zostanie bez zmian).*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 24

*Czy Zamawiający wymaga, żeby instrukcje obsługi i opakowania pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi zaoferowanych w grupie 73 były wydane w języku polskim.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział II pkt 1. Warunki dotyczące sposobu przygotowania oferty wymaga aby Oferta była napisana czytelnie w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone przez Wykonawcę.

**Zamawiający**